BLOKI INSMED

SZIAN - PODT. INSMED.PL

SKRZYNKA ZAWOROWO-INFORMACYJNO-ALARMOWA GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI TYP SZIAN

BLOKI - SZIAN	NAZWA	SZEROKOŚĆ (MM)	WYSOKOŚĆ (MM)	GŁĘBOKOŚĆ (MM)	WIDOK PODGLĄDOWY
SZIAN 1	SZIAN 1 (O2)	322	400	95	
SZIAN 2	SZIAN 2 (O2, VAC)	322	400	95	
SZIAN 3	SZIAN 3 (O2, AIR, VAC)	322	400	95	
SZIAN 4	SZIAN 4 (O2, N2O, AIR, VAC)	394	400	95	
SZIAN 5	SZIAN 5 (O2, N2O, AIR5, CO2, VAC)	460	400	95	
SZIAN 6	SZIAN 6 (O2, N2O, AIR5, AIR8, CO2, VAC)	525	400	95	

PSW INSMED.PL

PANEL SYGNALIZACJI WYNOŚNEJ PSW (24VDC)

BLOKI - SZIAN	NAZWA	SZEROKOŚĆ (MM)	WYSOKOŚĆ (MM)	GŁĘBOKOŚĆ (MM)	WIDOK PODGLĄDOWY
PSW-1	PSW - 1	170	145	47	
PSW-2	PSW - 2	170	145	47	
PSW-3	PSW - 3	170	145	47	
PSW-4	PSW - 4	170	145	47	
PSW-5	PSW - 5	170	145	47	
PSW-6	PSW - 6	170	145	47	

SZI - PION. INSMED.PL

SKRZYNKA ZAWOROWO-INFORMACYJNO- GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI TYP SZI pion.

BLOKI - SZI	NAZWA	SZEROKOŚĆ (MM)	WYSOKOŚĆ (MM)	GŁĘBOKOŚĆ (MM)	WIDOK PODGLĄDOWY
SZI-1 PION	SZI- 1 (O2)	322	400	95	
SZI-2 PION	SZI- 2 (O2, VAC)	322	400	95	
SZI-3 PION	SZI- 3 (O2, AIR, VAC)	322	400	95	
SZI-4 PION	SZI- 4 (O2, N2O, AIR, VAC)	394	400	95	
SZI-5 PION	SZI- 5 (O2, N2O, AIR5, CO2, VAC)	460	400	95	
SZI-6 PION	SZI- 6 (O2, N2O, AIR5, AIR8, CO2, VAC)	525	400	95	

TPG - PODT. (PPI) INSMED.PL

Tablica poboru gazów medycznych - podtynkowa
TPG - P (PPI)

BLOKI - TPG-P (PPI)	NAZWA	SZEROKOŚĆ (MM)	WYSOKOŚĆ (MM)	GŁĘBOKOŚĆ (MM)	TYP DI (PPI ALU)	TYP DP (PPI PLASTIK)
TPG2-P	TPG2-P (O2,VAC)	190	100	60		
TPG3-P	TPG3-P (O2,AIR,VAC)	270	100	60		
TPG4-P	TPG4-P (O2, N2O, AIR, VAC)	350	100	60		
TPG5-P	TPG5-P (2O2, N2O, AIR, VAC)	394	200	60		
TPG6-P	TPG6-P (2O2, 2AIR, 2VAC)	460	200	60		
TPG7-P	TPG7-P (2O2, 2N2O, 2AIR, VAC)	525	200	60		
TPG8-P	TPG8-P (2O2, 2N2O, 2AIR, 2VAC)	591	200	60		

TPG - PODT. (PPI + AGSS) INSMED.PL

Tablica poboru gazów medycznych - podtynkowa
TPG - P (PPI+ AGSS)

BLOKI TPG-P PPI+AGSS	NAZWA	SZEROKOŚĆ (MM)	WYSOKOŚĆ (MM)	GŁĘBOKOŚĆ (MM)	TYP DI (PPI ALU)	TYP DP (PPI PLASTIK)
TPG5-P	TPG5-P (2O2, N2O, AIR, AGSS)	394	200	60		
TPG6-P	TPG6-P (2O2, 2AIR, CO2, AGSS)	460	200	60		
TPG7-P	TPG7-P (2O2, 2N2O, 2AIR, AGSS)	525	200	60		
TPG8-P	TPG8-P (2O2, 2N2O, 2AIR, CO2, AGSS)	591	200	60		

TPG - NADT. (PPI) INSMED.PL

Tablica poboru gazów medycznych - nadtynkowa TPG - N (PPI)

BLOKI TPG-N PPI	NAZWA	SZEROKOŚĆ (MM)	WYSOKOŚĆ (MM)	GŁĘBOKOŚĆ (MM)	TYP DI (PPI ALU)	TYP DP (PPI PLASTIK)
TPG1-N	TPG1-N (O2)	100	100	61		
TPG2-N	TPG2-N (O2, VAC)	173	100	61		
TPG3-N	TPG3-N (O2, AIR, VAC)	253	100	61		
TPG4-N	TPG4-N (O2, N2O, AIR, VAC)	333	100	61		

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH - INSMED	PPI
BLOKI - PPI	NAZWA
PPI - O2	PUNK POBORU INSMED TLEN - PPI O2
PPI - N2O	PUNK POBORU INSMED PODTLENEK AZOTU - PPI N2O
PPI - AIR	PUNK POBORU INSMED SPRĘŻONE POWIETRZA - PPI AIR
PPI - CO2	PUNK POBORU INSMED DWUTLENEK WĘGLA - PPI CO2
PPI - VAC	PUNK POBORU INSMED PRÓŻNIA - PPI VAC
PPI - AGSS	PUNK POBORU INSMED ODCIĄG GAZÓW - PPI AGSS

Przykładowe opisy średnic rur



PRZYKŁĄDOWY PLAN

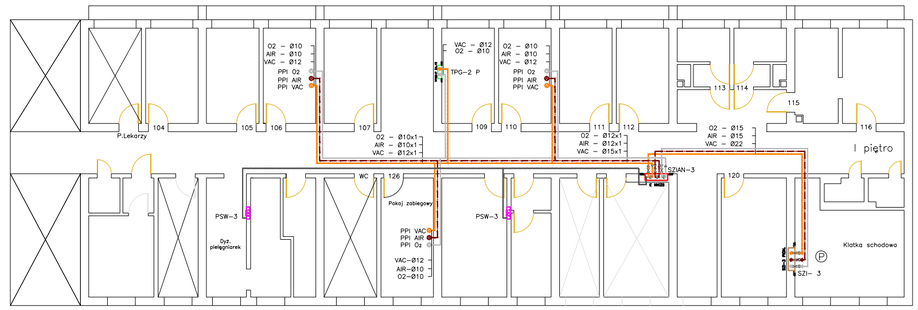

SCHEMAT ROZPRĘŻALNIE TRI- Z.A.

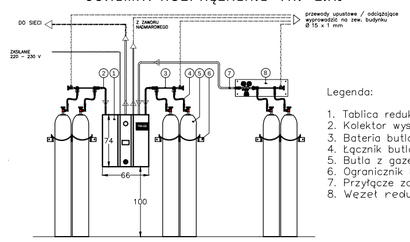

Legenda:

1. Tablica redukcyjna TRI– Z.A.
2. Kolektor wysokiegociśnienia
3. Bateria butlowa/zbieracz
4. Łącznik butlowy, spiralny
5. Butla z gazem
6. Ogranicznik Butli
7. Przyłącze zasilania awaryjnego
8. Wezeł redukcyjny

OZNACZENIA

- proj. przewody instalacji tlenu medycznego (O2)
- proj. przewody instalacji sprężonego powietrza (AIR)
- proj. przewody instalacji próżni (VAC)
- proj. podłączenie panelu sygnalizacji wynosnej PSW–3 (24VDC)
- PPI – O2 proj. Punkt poboru tlenu medycznego PPI – (O2)
- PPI – AIR proj. Punkt poboru sprężonego powietrza PPI – (AIR)
- PPI – VAC proj. Punkt poboru próżni PPI – (VAC)
- SZI-3 PION skrzynka zaworowo–informacyjno gazów medycznych SZI–3 (O2.AIR.VAC) PION
- SZIAN 3 skrzynka zaworowo–informacyjno–alarmowa gazów medycznych i próżni SZIAN–3 (O2.AIR.VAC) (24VDC)
- PSW-3 panel sygnalizacji wynosnej PSW–3 (24VDC)

SCHEMAT ROZPRĘŻALNIE TRI- T.C.

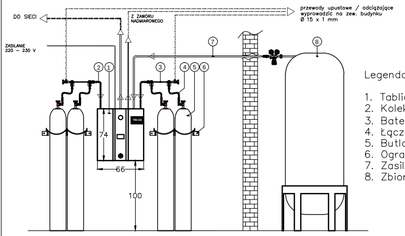

Legenda:

1. Tablica redukcyjna TRI– T.C.
2. Kolektor wysokiego ciśnienia
3. Bateria butlowa/zbieracz
4. Łącznik butlowy, spiralny
5. Butla z gazem
6. Ogranicznik Butli
7. Zasilanie tlenem ciekłym
8. Zbiornik tlen ciekły